

सामान्य सूचनाएं

PWS14620260216

वर्जन साधन ई 90/1 ATEX और स्टेनलेस स्टील संभावित वर्सिफोटक वातावरण में स्थापना के लिए डिजिटल कथित उद्योगों, फारमास्यूटिकल्स और पेंट के बहुमत के लिए आवश्यक सभी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। साधन की पूरी डिजिटल प्रोग्रामिंग पूर्व चल 4 बटन के माध्यम से सामने से सीधे कथित जाता है। साधन ई 90/1 गतशील माप के लिए पीक होल्ड समारोह का मालकि है, यह साधन में सीधे एक वकिल्प के रूप में स्थापति कथित जा सकता है Profibus- डी पी कारड के लिए सबसे आम पीएलसी धन्यवाद के साथ interfaced जा सकता है और लोड हो रहा है या उत्तराई में एक एकल घटक के मार्गदर्शन खुराक की अनुमतिदेता है। वर्जन साधन और 90/1 मानकों के साथ स्टेनलेस स्टील अनुपालन करें: EN50081-1, ईमसी के लिए EN5002-2; विद्युत सुरक्षा के लिए EN61010-1; ATEX दर्वतीय 2 जीडी के लिए 94/9 / EC; पूर्व घ आईआईगी T6 ÷ टी -4।




सभी डेटा सूचना के बानी परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरिदेश

PWS14620260216

माप सीमा:	0.5 ÷ +3.5 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 μ V/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्सल बहाव:	<0.001 % of full scale/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bits
एनकोडर आपूरति:	max 5 V (max 6 cells of 350 Ohm) through intrinsic safety barriers
डिविजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60000
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परचिलन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फ़िल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
त्रक आउटपुट:	2 outputs max 24 Vdc/100 mA cad
त्रक आदानों:	2 optoisolated 24 Vcc PNP (external power supply)
करमकि बंदरगाह:	RS232C or RS422/RS485
बजिली की आपूरति:	24 Vdc \pm 15 % - power consumption 5W or 115/230 Vac with integrated power supply
नियामक अनुपालन:	EN50081-1, EN5002-2 for EMC;
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU
बॉड दर:	2400, 9600, 19200, 38400, 115200 selectable
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
अनुपूर्ष उत्पादन:	16 bit


सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

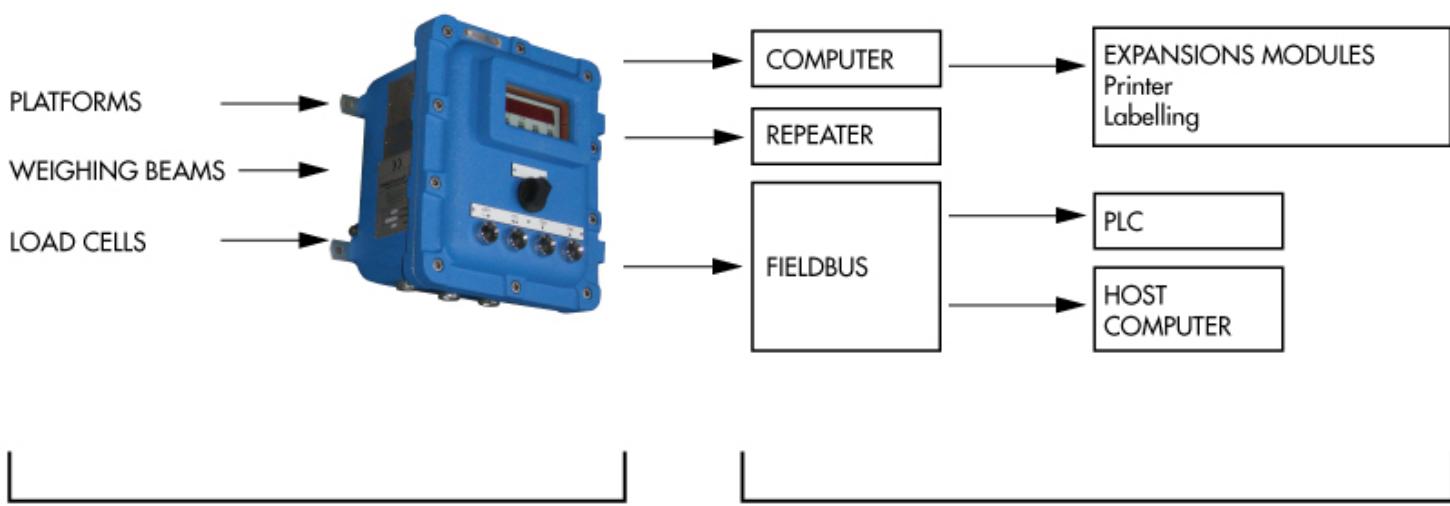

HAZARDOUS AREA

SAFE AREA

सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

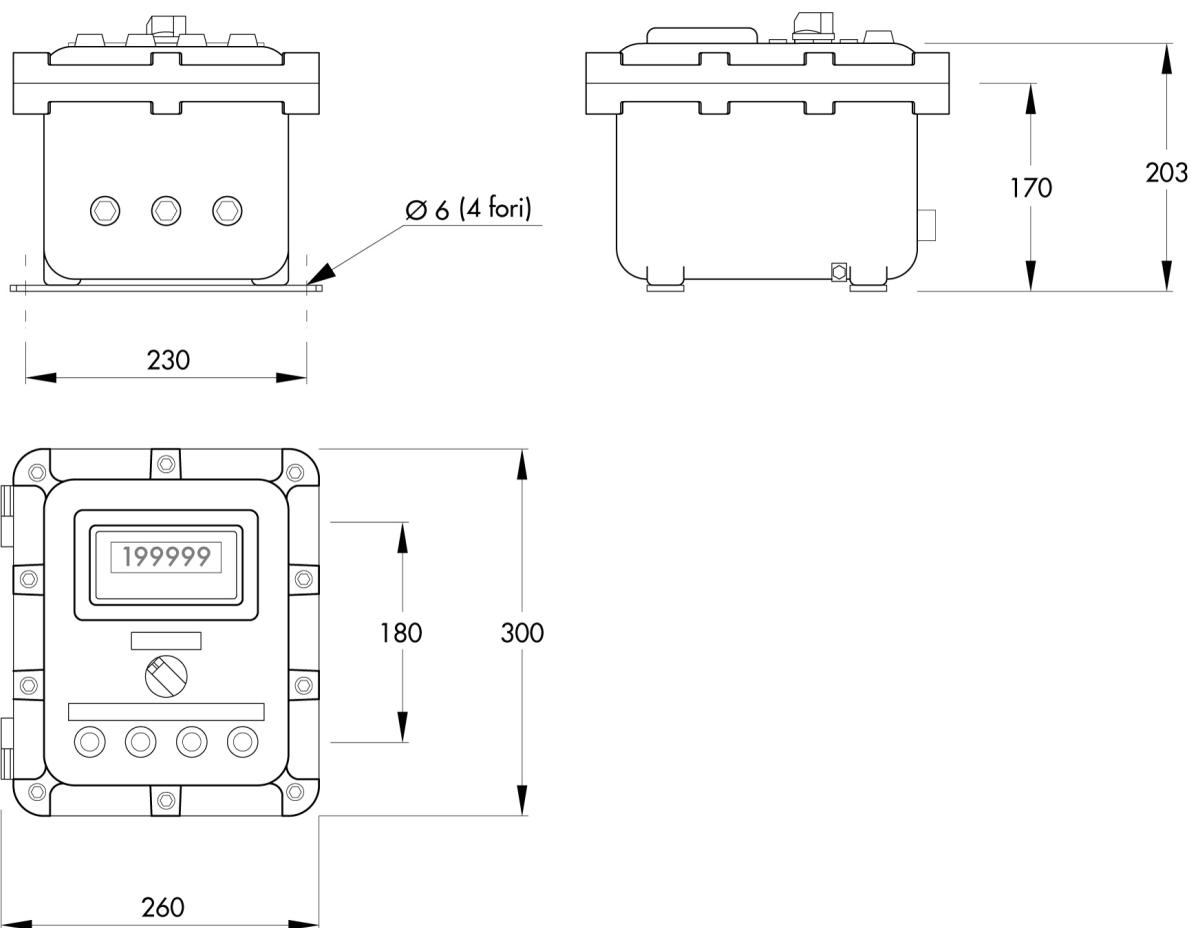

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनोटर (मार्मी) कर रहे हैं।